

สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ๓๐/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ โรงพยาบาลสกลนคร ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่าง โรงพยาบาลสกลนคร โดย นายธนสิทธิ์ ไพระพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๐๐๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติการรับบริจาคทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์การอนุมัติจ่ายเงินหรืออนุมัติก่อนนี้ผู้กู้เงินบริจาคให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าหน่วยบริการ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ อาคารลาซาลทาวเวอร์ ชั้น G/๒, ชั้น ๑ ชั้น ๒ อาคารเลขที่ ๑๐/๑๑ หมู่ที่ ๑๖ ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดย นายวิษณุ ฤทธิกิจณรงค์ บัตรประชาชนเลขที่ ๑ ๑๐๑๔ ๐๑๐๘๔ ๖๓ ๗ ผู้รับมอบอำนาจจาก นายบุญชัย วิเศษบรรจง กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สป. ๐๐๗๐๓๔ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๕๕๕๖๐๘๓๒๘๗ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดพกพา จำนวน ๑ เครื่อง รุ่น Vsacn ผลิตภัณฑ์ GE Healthcare รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๐,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว จำนวน ๑๘,๓๑๗.๗๖ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบบาทหกสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยจ่ายจากเงินบริจาคโรงพยาบาลสกลนคร

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายธนสิทธิ์ ไพระพงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายวิษณุ ฤทธิกิจณรงค์)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นายกิตติชัย พาระแพง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางภัชราพร วันทองสุข)

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญา

๓.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน ๒	แผ่น
๓.๒ ผนวก ๒ แคตตาล็อก	จำนวน ๔	แผ่น
๓.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา	จำนวน ๑	แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลสกจนคร ๑๐๔๑ ถ.เจริญเมือง ภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลสกจนคร ๑๐๔๑ ถ.เจริญเมือง ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๗ (เจ็ด) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา บางนา เลขที่ ๑๓๐-๗๔๑๘๙๒-๔ ชื่อบัญชี บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

(ลงชื่อ)..... ผู้ซื้อ

(นายธนสิทธิ์ ไพรพงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกจนคร

(ลงชื่อ)..... ผู้ขาย

(นายวิษณุ ฤทธิกิจณรงค์)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นายกิตติชัย พาระแพง)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางภัชราพร วันทองสุข)



ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่องของสิ่งของตามสัญญา เป็นเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่วินิจฉัยค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือข้อบกพร่อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อจะมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนศรีนครินทร์ กม.๑๕ เลขที่ ๑๐๐๐๖๗๕๓๓๓๖๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละห้า (๕%) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุทธวิธีครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้า เป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายธนสิทธิ์ ไพรพงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายวิษณุ ฤทธิกิจณรงค์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายกิตติชัย พาระแพง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางภัชราพร วันทองสุข)



หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญาแล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อจะมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม ข้อ ๖ และ ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๓ (สาม) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วนหรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม ข้อ ๖ และ ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิง ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

(ลงชื่อ)..... ผู้ซื้อ

(นายธนสิทธิ์ ไพระพงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร

(ลงชื่อ)..... ผู้ขาย

(นายวิษณุ ฤทธิกิจณรงค์)



(ลงชื่อ)..... พยาน

(นายกิตติชัย พาระแพง)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางภัชราพร วันทองสุข)

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนี้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรือ

(ลงชื่อ)..........ผู้ซื้อ

(นายธนสิทธิ์ ไพรงษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร

(ลงชื่อ)..........ผู้ขาย

(นายวิชณุ ฤทธิกิจณรงค์)

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นายกิตติชัย พาระแพง)

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางกัชรภาพร วันทองสุข)



อื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อจะมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายธนสิทธิ์ ไพรพงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร



(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายวิษณุ ฤทธิกิจณรงค์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายกิตติชัย พาระแพง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางภัชราพร วันทองสุข)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดพกพา

๑.คุณสมบัติทั่วไป

- ๑.๑ เป็นเครื่องเล็กกระทัดรัดสามารถพกพาได้สะดวก
- ๑.๒ เป็นเครื่องที่สามารถตรวจ Abdominal, OB-GYN, Lung, Cardiac and hemodynamic ได้
- ๑.๓ หัวตรวจของเครื่องเป็นชนิด Dual-Headed probe เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจ
- ๑.๔ ตัวเครื่องสามารถใช้งานกับไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิรตซ์ ประเทศไทย

๒.คุณสมบัติเฉพาะ

- ๒.๑ เป็นเครื่องตรวจอวัยวะภายในที่รองรับระบบ Android หรือ IOS ได้
- ๒.๒ ประมวลผลภาพด้วยระบบ Harmonic imaging เพื่อเพิ่มความคมชัดของภาพและลดสัญญาณรบกวน
- ๒.๓ ตัวเครื่องสามารถแสดง Centerline marker เพื่อช่วยแสดงระยะกึ่งกลางหน้าจอแสดงผลเพื่อช่วยในการทำหัตถการ (Out of Plane) ได้
- ๒.๔ ตัวเครื่องสามารถแสดง Focal zone เพื่อแสดงจุดที่สนใจขณะทำการตรวจได้
- ๒.๕ ตัวเครื่องสามารถปรับความสว่างตามความลึกได้ได้ ๖ ระดับ
- ๒.๖ ระบบการชาร์จไฟของหัวตรวจเป็นระบบ wireless charger
- ๒.๗ ตัวเครื่องสามารถ Measurements (distance, ellipse) ได้

๓.คุณสมบัติหัวตรวจ Curved array transducer


- ๓.๑ สามารถตรวจอวัยวะส่วนลึกได้
- ๓.๒ ช่วงของความถี่ของหัวตรวจอยู่ที่ ๒-๕ MHz
- ๓.๓ มุมมองของภาพ ๖๐ องศา
- ๓.๔ สามารถตรวจความลึกได้สูงสุดที่ ๒๔ เซนติเมตร ขึ้นอยู่โปรแกรมที่ใช้ตรวจ

๔.คุณสมบัติหัวตรวจ Linear array transducer

- ๔.๑ หัวตรวจสามารถตรวจอวัยวะส่วนตื้นได้
- ๔.๒ ช่วงของความถี่ของหัวตรวจอยู่ที่ ๓-๑๒ MHz
- ๔.๓ สามารถตรวจความลึกได้สูงสุดที่ ๘ เซนติเมตร ขึ้นอยู่โปรแกรมที่ใช้ตรวจ

๕.คุณสมบัติอื่นๆของเครื่อง

- ๕.๑ ตัวเครื่องสามารถ Setting auto Freeze ได้
- ๕.๒ ตัวเครื่องสามารถตั้งค่า video duration ได้



(ลงชื่อ)..... ผู้ซื้อ
()
(ลงชื่อ)..... ผู้ขาย
()
(ลงชื่อ)..... พยาน
()
(ลงชื่อ)..... พยาน
()

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายสถาพร โมราราช

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางสาวจินดารัตน์ ชัยโพธิ์คำ

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางศศิธร บุญฤกษ์

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๖.คุณสมบัติ Data Storage

- ๖.๑ การจัดเก็บภาพในรูปแบบ jpg หรือ mp4 หรือ MP๔ ได้
- ๖.๒ การจัดเก็บภาพสามารถเรียกภาพเก่ากลับมาดูได้
- ๖.๓ รองรับระบบจัดเก็บภาพแบบ DICOM ได้

๗.ระบบ Supported Mobile Platforms

- ๗.๑ ระบบสามารถทำงานบน Android phones และ Tablets ได้
- ๗.๒ ระบบสามารถทำงานบน iPad และ iPhone ได้
- ๗.๓ หน้าจอแสดงผลสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ ๕-๒๐ นิ้ว
- ๗.๔ ความจำเครื่องเพื่อจัดเก็บภาพอย่างน้อย ๘GB หรือมากกว่า


๘.ระบบการเชื่อมต่อ

- ๘.๑ เป็นระบบ peer-to-peer connectivity (Android only)
- ๘.๒ เป็นระบบ Bluetooth ELE ๔.๐

๙.ได้รับมาตรฐาน IEC ๖๐๖๐๑-๑, IEC๖๐๖๐๑-๑-๒, IEC ๖๐๖๐๑-๒-๓๗, ISO๑๐๙๙๓-๑ เป็นอย่างน้อย

๑๐.เงื่อนไขอื่นๆ

- ๑๐.๑ รับประกันเครื่องเป็นระยะเวลา ๑ ปีพร้อมทั้งมีการตรวจเช็คสภาพเครื่องและทำความสะอาดเครื่องทุกๆ ๖ เดือนภายในระยะเวลารับประกัน
- ๑๐.๒ ผู้ขายจัดส่งเจ้าหน้าที่ชำนาญงานหรือผู้แทนมาสาธิตการใช้งานเครื่องเมื่อส่งมอบเครื่อง
- ๑๐.๓ มีเอกสารสอนการใช้งานแบบง่ายให้อย่างละ ๑ ชุด
- ๑๐.๕ ผู้ขายมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ มาแสดง


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
นายสถาพร โมราราช
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
นางสาวจินดารัตน์ ชัยโพธิ์คำ
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
นางศศิธร บุญฤกษ์
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(ลงชื่อ)..........ผู้ซื้อ
(
(ลงชื่อ)..........ผู้ขาย
(
(ลงชื่อ)..........พยาน
(
(ลงชื่อ)..........พยาน
(

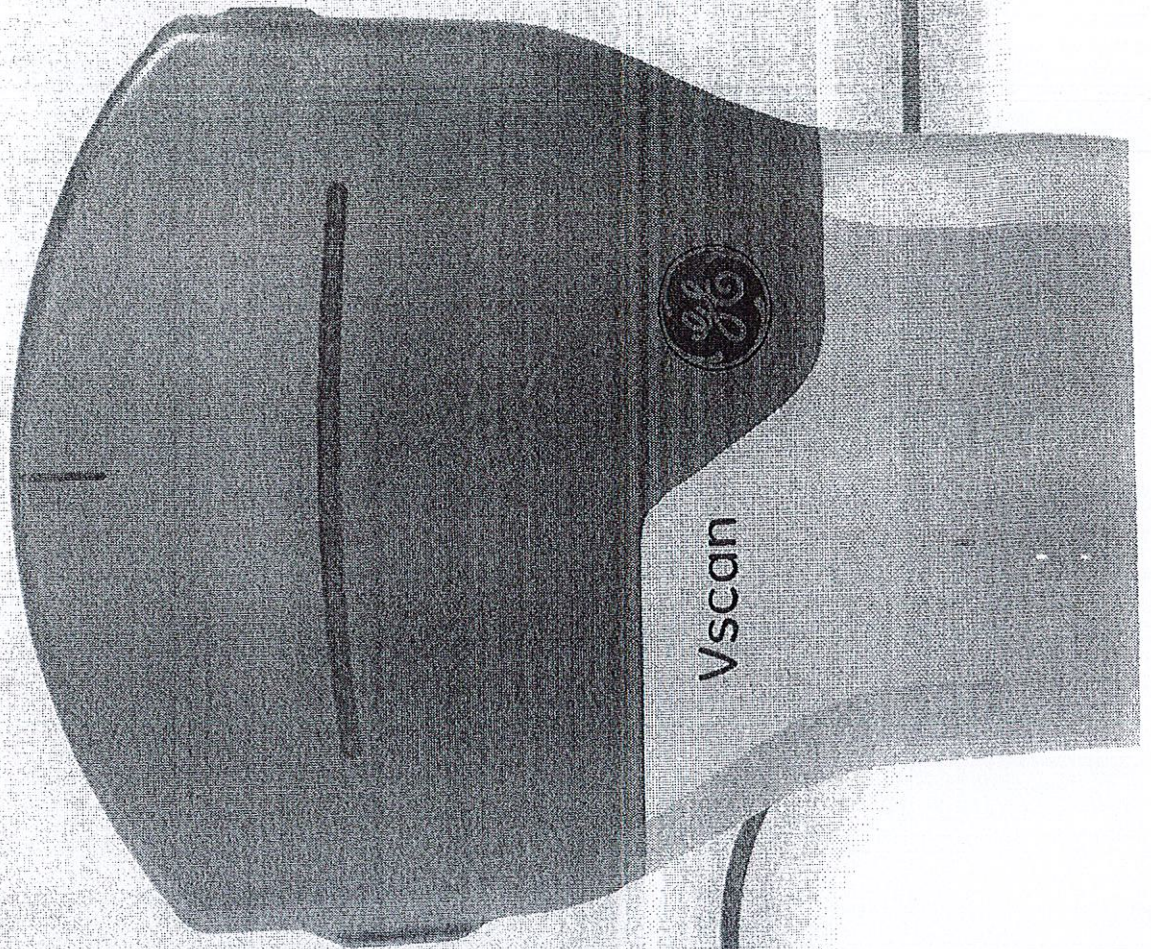

Vscan Air™


See more. Treat faster.



(ลงชื่อ).....	Dr.	ผู้ซื้อ
(ลงชื่อ).....	Dev	ผู้ขาย
(ลงชื่อ).....		พยาน
(ลงชื่อ).....		พยาน

Ready for a new view?

Get crystal-clear images with the power of a high-performance ultrasound machine in a small, lightweight and wireless solution.

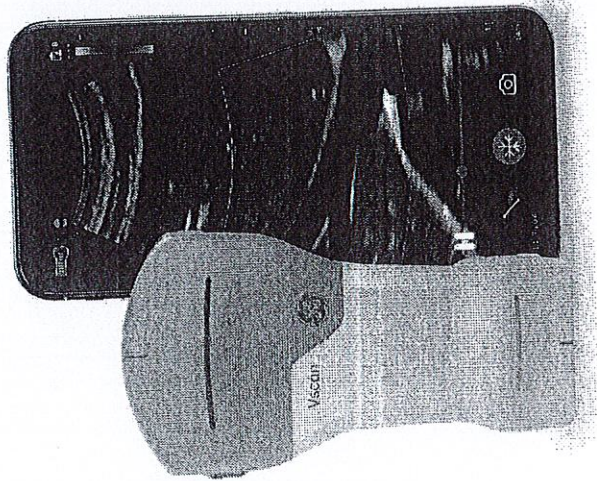

Insight right in your pocket

Supports early diagnosis and helps you quickly decide on next steps.

Dual-probe imaging power Complete both shallow and deep scans without switching probes or compromising on image quality.

Durability, defined Withstands everyday handling from scratches to drops and even a rainstorm.*

Developed for clinicians

It is easy to use, intuitive to navigate and optimized for your mobile device**



(ลงชื่อ) _____
 (ลงชื่อ) _____
 (ลงชื่อ) _____
 (ลงชื่อ) _____

นาย พยาน
 พยาน

*Probe withstands drops: tested to Military drop standards (MIL-810G). IP67, waterproof, compatible with high level disinfection techniques.
 **Works with a range of Android and iOS smartphone and tablets.

Experience handheld ultrasound without compromising on portability or image quality



Break free.

Take Vscan Air anywhere* with wireless freedom and maximum portability. Its small, lightweight and wireless dual-probe provides you with a convenient, durable and flexible handheld ultrasound solution.



Clear images.
Informed decisions.

Engineered with SignalMax™ technology,

Vscan Air delivers sharp images to support early disease detection and help monitor treatment.



By your side.

We support your ultrasound journey from first scan to confident use. Make the most of your system from the easy-to-use probe and intuitive app to GE Healthcare's renowned service and educational tools. Vscan Air comes with a 3-year worry-free warranty.

*The device has been verified for limited use outside of professional healthcare facilities. Use is restricted to environmental properties described in the user manual. Please contact your GE Healthcare sales representative for detailed information.



Securely store, share and collaborate

Flexible wireless dataflow:

- DICOM®, including query from Modality Worklist server, Store to DICOM PACS, receive Storage Commitment
- JPG/MPG export to shared network folders (supports importing into EMR)
- Share auto-anonymized images with other apps
- No cloud required



DICOM server



Shared folder



Other apps

Security:

- Secure DICOM including the option of Peer Authentication
- Secure User Authentication
- Passwords required to access patient data

SignalMax™ Technology


Power of a high-performance system
in a pocket-sized solution

See into the whole body with
dual-probe (2 in 1) technology

Console-quality signal processing
in a miniaturized chipset


Stunning image quality in a
wireless handheld device

Builds upon GE's expertise in
ultrasound innovation

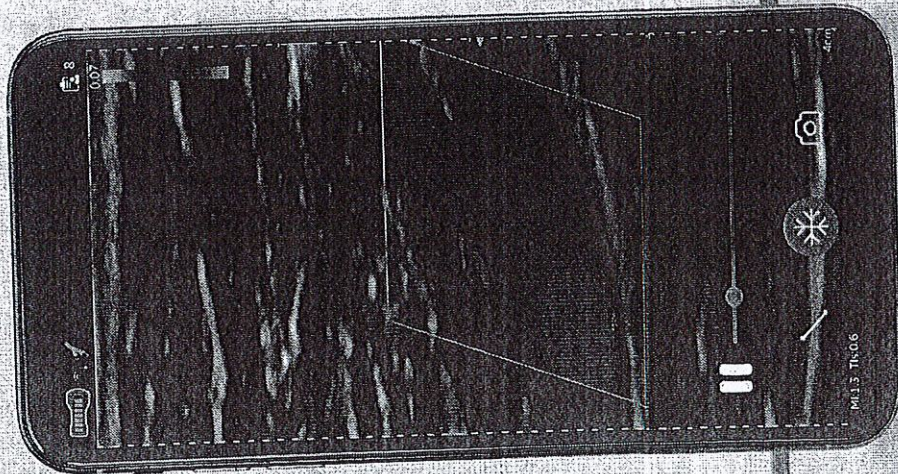

Vscan Air™

See more. Treat faster.

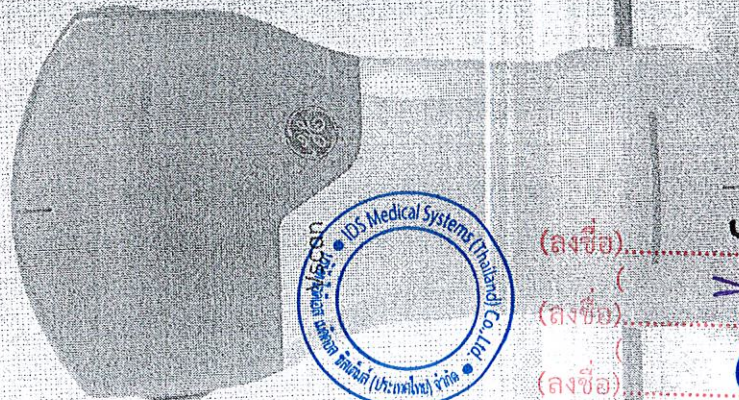

(ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....

ผู้ซื้อ
 ผู้ขาย
 พยาน
 พยาน







© 2021 General Electric Company. All rights reserved. GE, the GE Monogram and Vscan Air are trademarks of General Electric Company. GE Healthcare, a division of General Electric Company. GE Medical Systems, Inc. doing business as GE Healthcare. DICOM is a registered trademark of the National Electrical Manufacturers Association. Products mentioned in the material may be subject to government regulation and may not be available in all countries. Shipment and the effective sale can only occur after approval from the regulator. Please check with your local GE Healthcare representative for details.



IDS Medical Systems (Thailand) Company Ltd.
 Lasalle Tower, Floor G/2, Floor 1-2, 10/11 Moo 16
 Srinakarin Road, Bangkeaw, Bangphli, Samutprakarn 10540, Thailand
 T : +66 2 349 4780 - 3
 F : +66 2 758 8874; +66 2 758 8883
 E : salesth@idsMED.com
 www.idsMED.com (Tax ID : 0105556093287)

ใบเสนอราคา

เรื่อง เสนอราคา เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดพกพา		เลขที่ UCP16/661116-082		
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร		วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566		
สิ่งที่ส่งมาด้วย แค็ตตาล็อก พร้อมรายละเอียด		อ้างอิง		
บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเสนอราคาருภัณฑ์การแพทย์ ผลิตภัณฑ์ GE Healthcare				
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้				
จำนวน	ผลิตภัณฑ์	รายการ	หน่วยละ	ราคารวม
1	เครื่อง GE Healthcare	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดพกพา รุ่น VScan Air	350,000.00	350,000.00
		ผลิตภัณฑ์ GE Healthcare		
				
				
		อุปกรณ์ประกอบ: - Wireless Charger จำนวน 1 ชิ้น		
		- ราคานี้ รวมหัวตรวจชนิด Convex Probe และ Linear Probe		
		- ราคานี้ รวมหน้าจอแสดงผล		
		- INNOQ ULTRASOUND GEL, BLUE, 5KG : 1BT		
		หมายเหตุ: ลดราคาพิเศษเฉพาะงบบริจาคเท่านั้น		70,000.00
		- รับประกันคุณภาพ 1 ปี	ยอดสุทธิ	280,000.00
		- กำหนดส่งของภายใน 120 วัน นับจากวันรับใบสั่งซื้อ	ราคาสินค้า	261,682.24
		- กำหนดยื่นราคา 90 วัน นับจากวันเสนอราคา	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	18,317.76
		- เงื่อนไขการชำระเงิน : 90 วัน	ราคาสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	280,000.00
สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาสั่งซื้อจากท่าน และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้				
ขอแสดงความนับถือ				
ในนามบริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด				
ผู้เสนอราคา	นายวิษณุ ฤทธิกิจณรงค์			
	มือถือ 086 375 5216	(นายพงศ์วิระ ไตรสรณิกษ์)		
ผู้ออกเอกสาร	นางสาวกัทลิตี อารยะชนารัตน์	Principal Sales Specialist - North Eastern		

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 10/11 Moo 16 ถนนศรีนครินทร์, ต.บางแก้ว, อ.บางพลี, จ.สมุทรปราการ 10540

T : +66 2 349 4780 - 3, F : +66 2 758 8874; +66 2 758 8883 E : salesth@idsMED.com

FP-SAL-01-02 Rev.01



(ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ)..... พยาน